Traceability Chart

หมายเลขเอกสาร :		แก้ไขที่ : 0
DRAF Date :	CHECK Date :	APPROVE Date :

Name of Laboratory : Thai-Korea Calibration Center Co.,Ltd. (TKCC)

Acreditation No. : Accredit by TLAS Calibration No. 0116

Calibration procedure : WL-E009 AC WATTMETER

Calibration scope for : 9.9 W to 3 000 W @ 45 Hz to 65 Hz (at 33 V to 300 V, 0.3 A to 10A)
Power factor = 1
3 000 W to 10 kW @ 45 Hz to 65 Hz (at 300 V to 500 V, 10 A to < 20 A)
Power factor = 1

Traceable to National Metrology Institute (NMI)

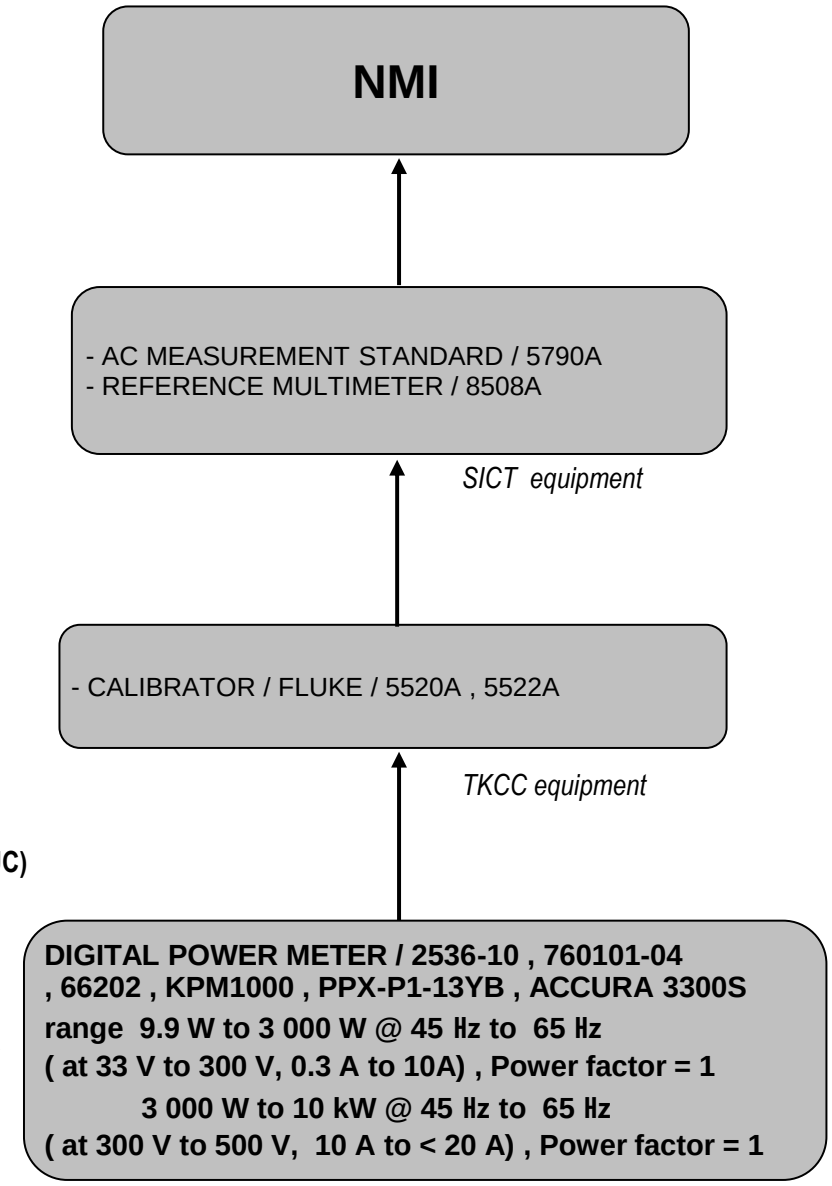

Remark :

NMI : National Matrology Institute
KRISS : Korea Reserch Institue of Standard and Science (Replublic of Korea)
NIMT : National Institute of Metrology (Thailand)
SICT : Institute of Calibration & Technology Co.,Ltd.